



① 恥骨をさがす




プローブの下端を恥骨直上部まで動かす。
その位置でコードマークをおへそに合わせ調節する。

② マークの位置を決める




いったんプローブを外し、コードマークの位置を下げる。
※ 女性は下へ5ミリ。
※ 男性は下へ10ミリ。

③ パッドをはがす

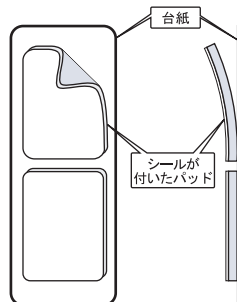


印刷されているシールを貼ったままにしてパッドを台紙よりはがす。

④ パッドに水をぬる




台紙よりはがした面に少量の水(水1滴)をつけ、パッド全面にぬる。

⑤ パッドをプローブに貼る




水をつけた面をはじから気泡が入らない様にプローブに貼り付ける。

⑥ 気泡がない事を確認




気泡がある場合は、指で気泡を押し出す。

⑦ 印刷シールをはがす

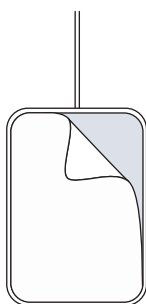


印刷されているシールをはがす。

⑧ パッド面に水をぬる

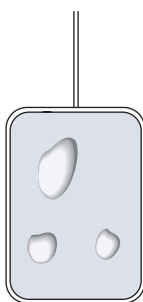

パッド面に少量の水をつけ、全面にぬる。

⑨ プローブを測定位置に貼る



コードマークをおへそに合わせ、そのままコードをまっすぐ下ろし、プローブのパッド面に肌に貼り付ける。気泡がない様に肌に軽く押し付ける。測定を始める。